

# APPROCHE A VUE

## Visual approach

Transport public à la demande  
Common carriage on request

**ROYAN**  
Centre hospitalier/Hospital  
AD 3 APP 01

03 NOV 22


	<b>ALT : 81 (3 hPa)</b>	Non WGS-84
	LAT : 45 38 00 N	VAR : 0° (20)
	LONG : 001 03 39 W	

FIS : AQUITAINE Information 120.575

EN TERRASSE / TERRACED

AFIS : ROYAN Information 118.800

COM : NIL

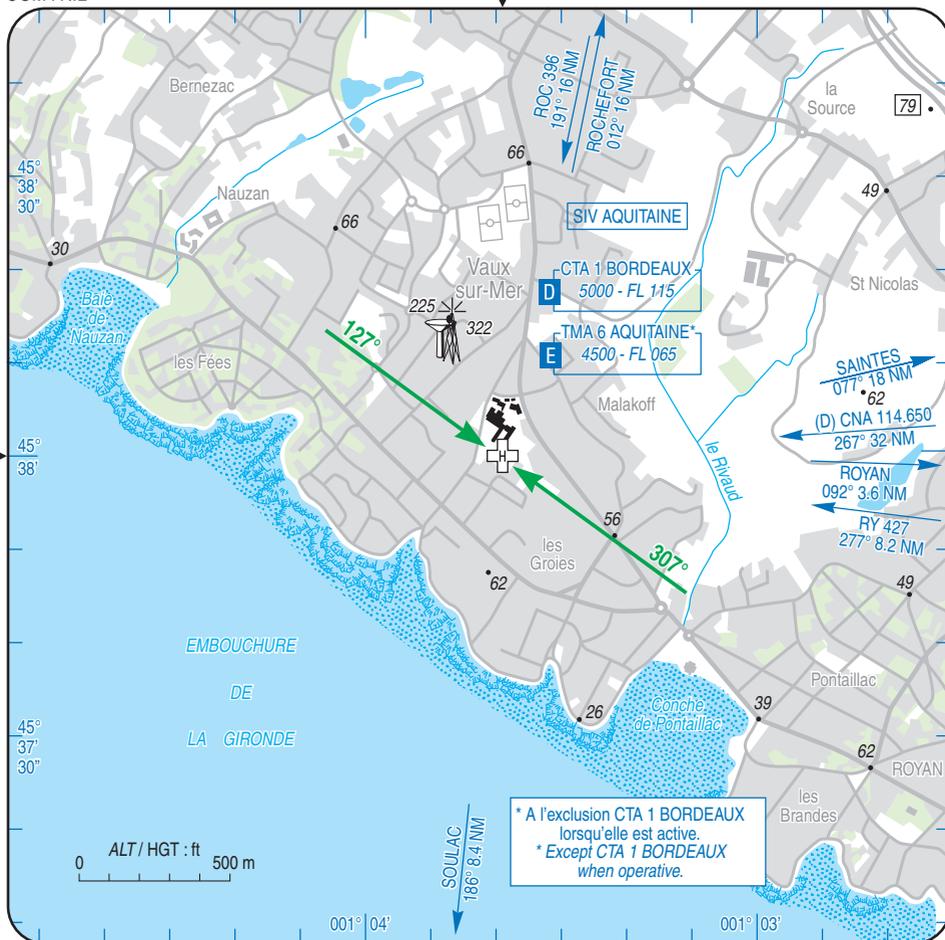

\* A l'exclusion CTA 1 BORDEAUX  
lorsqu'elle est active.  
\* Except CTA 1 BORDEAUX  
when operative.

### CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Hélistation réservée au Service Médical d'Urgence Hélicoptéré (SMUH). / Helistation reserved for emergency medical service flights (HEMS).


En phase de recul, respecter un taux de montée maximal compatible avec le manuel de vol de l'hélicoptère. Dans la mesure du possible, cause nuisance, éviter la phase de recul au-dessus des habitations au Sud-Est.

During recoil phase, observe a maximum climb rate compatible with the helicopter flight manual. If possible, due to noise pollution, avoid recoil phase over South-East built up areas.

Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 4.5%

Utilisation de nuit / Night use : oui / yes

Utilisation en IFR / IFR use : non / no

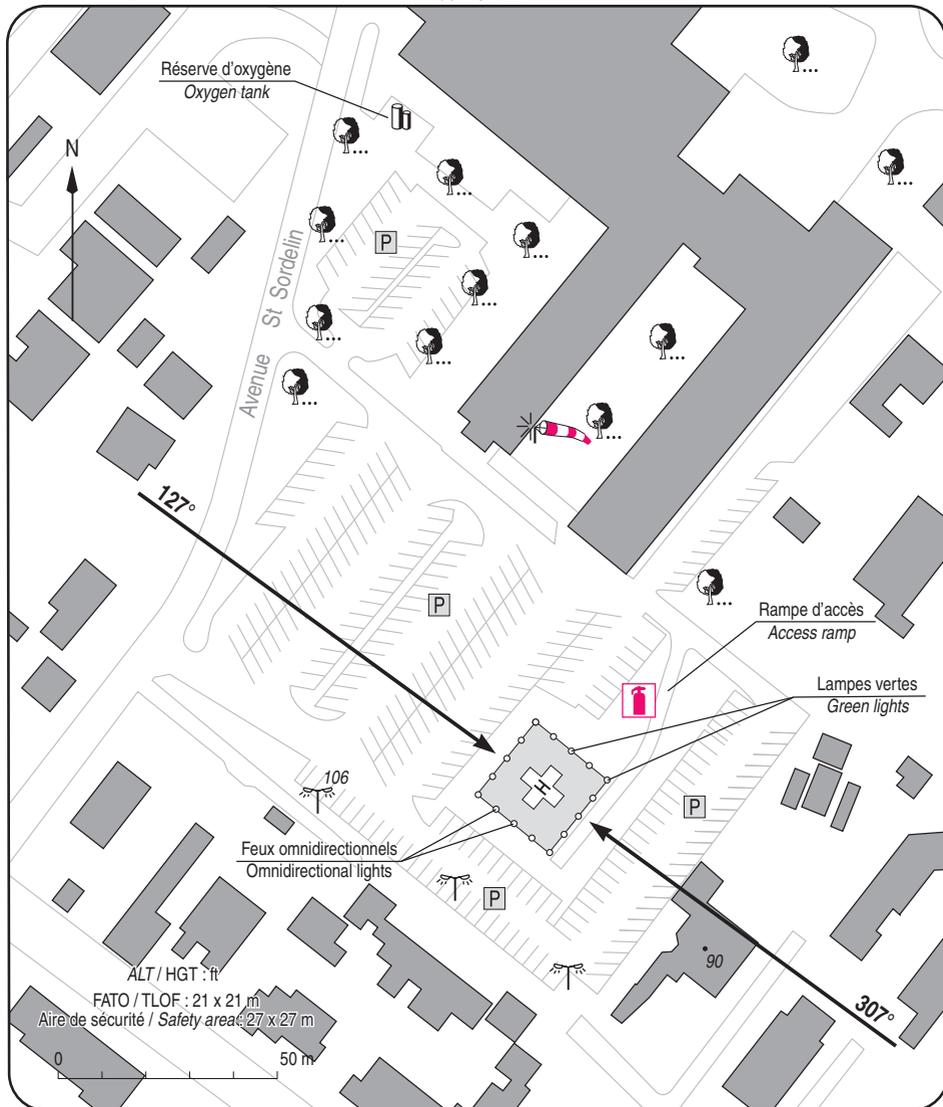

**1 - Exploitant / Operator :**

Hôpital de Royan ☎ 05 46 39 52 52 - FAX : 05 46 38 69 25

**2 - CAA : DSAC Sud-Ouest**

**3 - AVT : NIL**

**4 - RFFS :** 1 extincteur poudre 50 kg / 1 fire extinguisher powder 50 kg

1 extincteur poudre 9 kg / 1 fire extinguisher powder 9 kg

1 extincteur CO2 5 kg / 1 fire extinguisher CO2 5 kg

**5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL**

**6 - Hangars disponibles / Hangar available : NIL**

**7 - Réparations / Repairs facility : NIL**

**8 - Type de surface / Surface : enrobé / asphalt**

**9 - Force portante / Strength : 4.2 t**