

APPROCHE A VUE

Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request


ARRAS
Centre hospitalier/Hospital
AD 3 APP 01

03 OCT 24

	ALT : 254 (10 hPa) LAT : 50 17 49 N LONG : 002 45 36 E	VAR : 1° E (2020)
---	---	-------------------

FIS : LILLE Information 126.480
SAMU 62 : 122.975

EN SURFACE / ABOVE GROUND

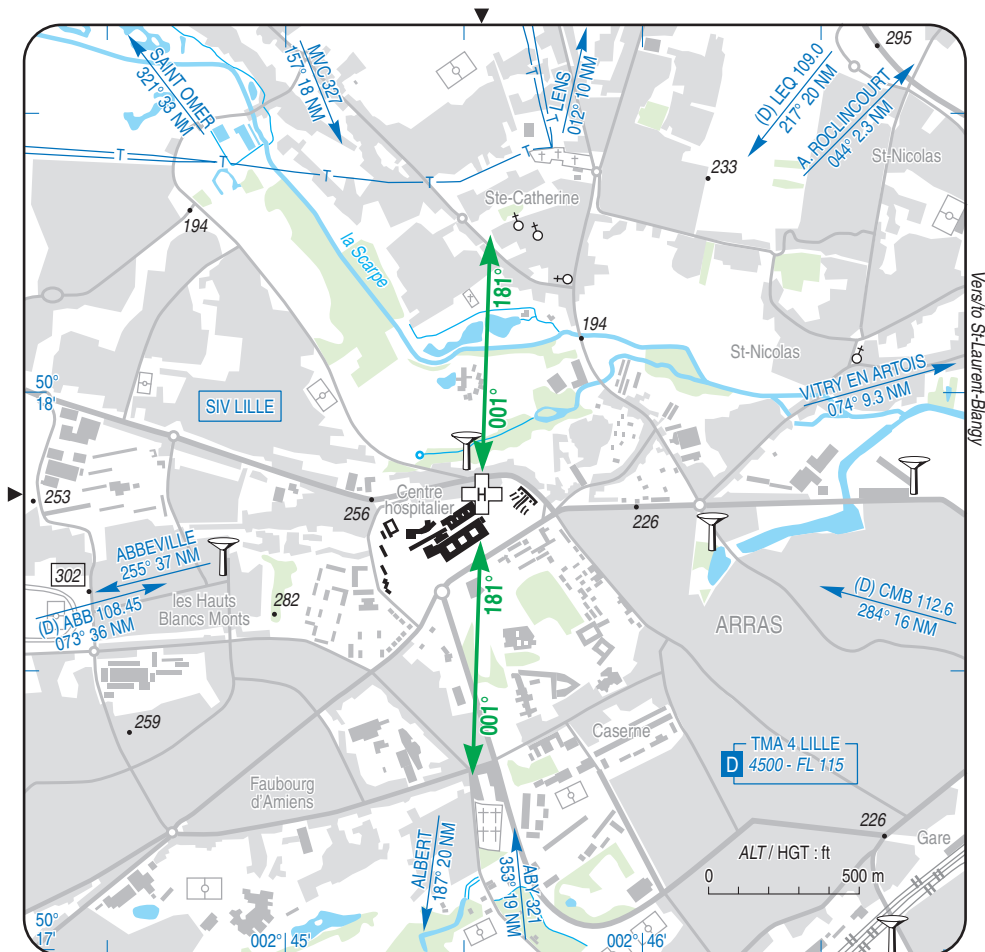

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Utilisation de nuit /Night use : oui/yes

Utilisation en IFR /IFR use : non/no

Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 4.5 %

ARRAS


Centre hospitalier/Hospital

AD 3 ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

03 OCT 24

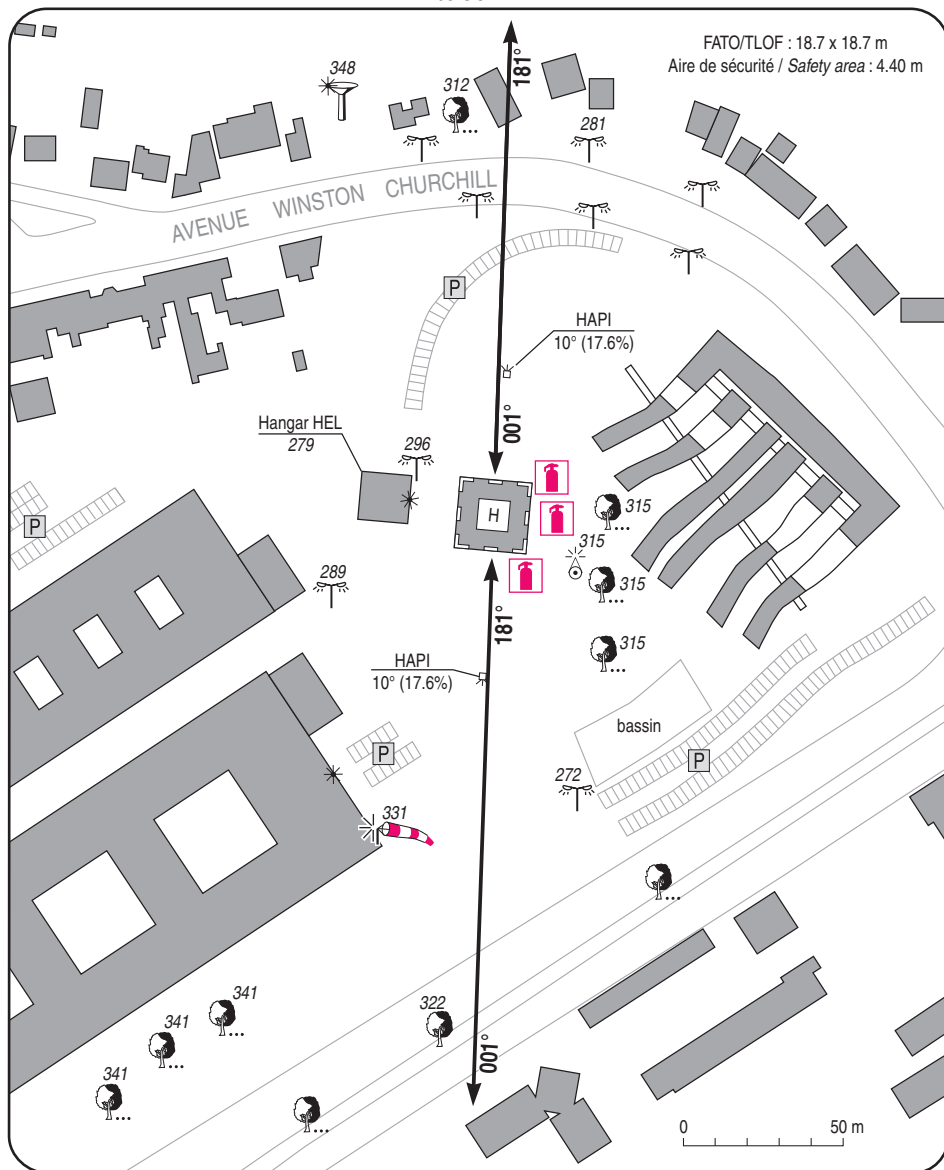

1 - Gestionnaire / Administrator :

Centre hospitalier d'Arras ☎ / FAX : 03 21 21 10 57

2 - CAA : Délégation Hauts de France Nord (Voir / See GEN)

3 - AVT : Usage restreint / restricted use

4 - RFFS : Oui (50 kg poudre/powder + 2 x 9 kg poudre/powder)

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Available hangars : oui/yes

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : béton / concrete

9 - Force portante / Strength : 4.3 t



ARRAS Centre hospitalier / Hospital

Consignes particulières / Special instructions

Equipement hélistation

PCL : sur 122.975

Balisage :

- 3 coups d'alternat : feux verts omnidirectionnels.
- 5 coups d'alternat : feux verts + spots blancs.
- 7 coups d'alternat : extinction du balisage.

Caractéristiques FATO/TLOF :

Feux verts omnidirectionnels et spots périphériques.

Helistation equipment

PCL : on 122.975

Lighting :

- 3 microphone switch actions: omnidirectional green lights.
- 5 microphone switch actions : green lights + white spotlights.
- 7 microphone switch actions : switching off the lighting.

FATO/TLOF characteristics :

Omnidirectional green lights and peripheral spotlights.